



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, 12.07.2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku - II SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy RZP-V/1/21/11**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pytanie:

Dotyczy wszystkich zestawów, serwet, fartuchów i akcesoriów:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jedną etykietę samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na jedną etykietę samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Pytanie:

Dotyczy zestawów (poz. 22, 23 i 24):

Czy Zamawiający dopuści zestawy o następujących parametrach:

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33 μ , w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza zestawy o ww. parametrach.

Pytanie:

Dotyczy serwet na stolik Mayo:

Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo (w zestawach) o następujących parametrach:

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33 μ , w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza serwetę MAYO o ww. parametrach:

Pytanie:

Pakiet nr 1:

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25 i 26 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji i utworzenie odrębnego pakietu.

Pytanie:

Poz. 20 i 21. Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę RTG o średnicy 90 cm wykonaną z folii o grubości 40 mikronów?

Odpowiedź:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Nie – Zamawiający nie dopuszcza osłony na aparaturę RTG o średnicy 90 cm wykonaną z folii o grubości 40 mikronów.

Pytanie:

Poz. 22. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji stawu biodrowego o ww. składzie.

Pytanie:

Poz. 23. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm

1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łata chłonna 50x100 cm i uchwytem na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji kolana o ww. składzie.

Pytanie:

Poz. 24. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o ww. składzie:

Pytanie:

PAKIET NR 1

Pozycje 1,2,3,4,5,6,7,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

- Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

NIE – Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Pozycje 20, 21

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu gramatury. Pragniemy zauważyć, że wymagana przez Zamawiającego gramatura 40 g/m² dotyczy wyrobów z włókniny a nie z folii polietylenowej.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie:

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pokrowca na aparaturę RTG o średnicy 85 cm?

Odpowiedź:

Nie – Zamawiający nie dopuszcza pokrowca na aparaturę RTG o średnicy 85 cm.

Pytanie:

Pozycje 22,23,24

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów wykonanych z 2-warstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi. W skład wchodzi barierowa warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej. Waga materiału podstawowego bez wzmocnienia 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; grubość materiału bez wzmocnień około 350 μm, grubość wzmocnienia 630 μm (pad + materiał podstawowy). Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O oraz na rozerwanie na sucho obszary niewzmocnione >150 kPa; obszary wzmocnione >300 kPa?
- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na Stolik Mayo wykonanej z włókniny o gramaturze: błona – 57 g/m², błona +włóknina – 93 g/m², błona + wzmocnienie 134 g/m²; grubość filmu około 60 μm; film + włóknina około 340 μm. Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho film >80 kPa ; film + włóknina >180 kPa?
- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ściereczek chłonnych o gramaturze 60 g/m² i rozmiarze 33cm x 33cm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania produktów o ww. parametrach w poz. 22, 23, 24.

Pytanie:

Pozycja 22


- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu serwet do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

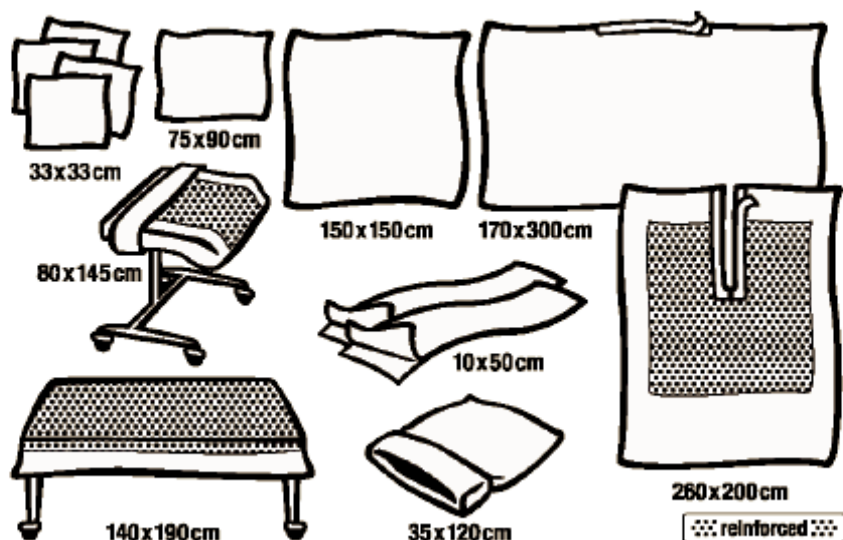

*Miejsca wykropkowane:
obszary wzmocnione*

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm
- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
- 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończyne 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm .

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji stawu biodrowego o ww. składzie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:


„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Pozycja 23

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji stawu kolanowego o następującym składzie:

*Miejsca
wykropkowane:
obszary wzmocnione*

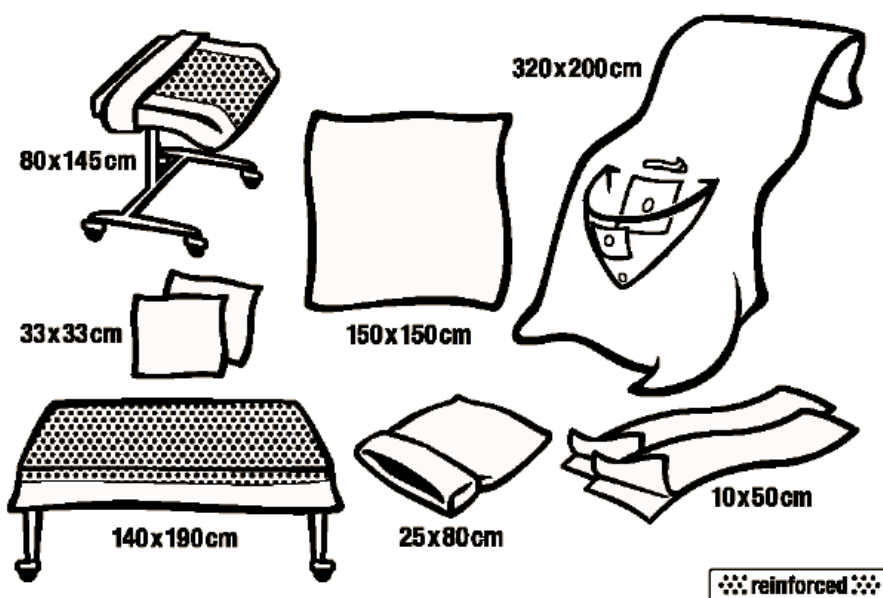

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm .

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji stawu kolanowego o ww. składzie:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>


Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Pozycja 24

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:
Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

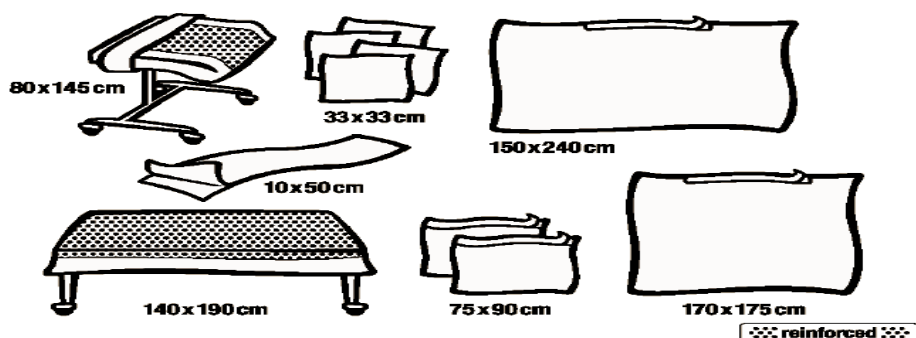

1 serweta na stółik
narzędziowy 140 x 190
cm

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- Oraz oddzielnie pakowaną dołączoną do zestawu kieszeń samoprzylepną dwukomorową o rozmiarze 43 x 38 cm?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o ww. składzie:

Pytanie:

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny Spounlace (55% pulpy cebulowej, 45% PES), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający wymaga fartuchów zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie:

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza fartucha z włókniny SMS.

Pytanie:

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 30x28 cm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną w rozmiarze 30x28 cm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 56x84 cm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną w rozmiarze 56x84 cm.

Pytanie:

Pozycja 13, 20-24

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 13,20-24 z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 13,20-24 z pakietu.

Pytanie:

Pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny + laminat?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający wymaga serwet zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie:

Pozycja 20-21

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z folii PE?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza pokrowca z folii PE.

Pytanie:

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta 170 x 240 cm Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza zestaw o ww. parametrach.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza zestaw o ww. parametrach.

Pytanie:

Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

+ osobno taśma lepna

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza zestawu o ww. parametrach.

Pytanie:

Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna, dolna z łąką chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łąką chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza zestawu o ww. parametrach.

Pytanie:

Pozycja 26

Prosimy o doprecyzowanie, co ma wchodzić w skład zestawu: poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę, czy prześcieradło + poszewka na kołdrę?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga zestawu pościelowego jednorazowego dwuczęściowego: poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w razie zaoferowania produktów o parametrach, które zamawiający dopuścił w ww. wyjaśnieniu, należy w Formularzu cenowym złożonej oferty dokonać odpowiednich poprawek.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Grzegorz Ratajczyk
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk