



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, 07 czerwca 2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy RZP-V/1/16/11**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 20x30cm lub 28x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści folii o rozmiarze 20 x 30 cm , natomiast dopuści folię o rozmiarze 28 x 30 cm.

Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 56x84cm?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 56x84cm

Pakiet nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50m lub 80m z przeliczeniem ilości zamawianej?

TAK - Zamawiający dopuści podkład o długości 50m lub 80m z przeliczeniem ilości zamawianej zgodnie z zapisem jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 210x130cm lub 200x150cm?

TAK - Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 210x130cm lub 200x150cm.

Pakiet 1, poz.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niesterylnego podkładu włókninowego o wymiarach 210 x 130 lub 210 x 160cm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie niesterylnego podkładu włókninowego o wymiarach 210 x 130 lub 210 x 160 cm

Dotyczy wszystkich zestawów, serwet, fartuchów i akcesoriów:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jedną etykietę samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź :

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na jedną etykietę samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Pakiet nr 1:

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25 i 26 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża na wydzielenie poz. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,25,i 26, na utworzenie odrębnego pakietu.

Pakiet nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pokrowca na aparaturę RTG o średnicy 85 cm?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuści zaferowania pokrowca na aparaturę RTG o średnicy 85 cm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pakiet nr 1 poz. 20, 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową: górna z elastyczną gumką 100 x 60 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuści osłony na ramię C uniwersalną 3 częściową: górna z elastyczną gumką 100 x 60 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm oraz nie wydzieli do osobnego pakietu

Pakiet nr 1 poz. 20 i 21.

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę RTG o średnicy 90 cm wykonaną z folii o grubości 40 mikronów?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuści osłonę na aparaturę RTG o średnicy 90 cm wykonaną z folii o grubości 40 mikronów.

Pakiet nr 1

Pozycje 1,3,4,5,6,7,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenie ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu w rozmiarze 150cm x 200 cm?

Odpowiedź :

TAK - Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu w rozmiarze 150cm x 200 cm

Pakiet nr 1 poz. 2, 5, 13

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2, 5 13 do osobnego pakietu.

UWAGA! Odpowiedzi na poniższe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Dotyczy zestawów (poz. 22, 23 i 24):

Czy Zamawiający dopuści zestawy o następujących parametrach:

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O?

Dotyczy serwet na stolik Mayo:

Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo (w zestawach) o następujących parametrach:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”


Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33 μ , w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m²
Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >168 kPa
Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 168 kPa
Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H₂O

Pakiet nr 1 poz. 22,23,24

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów wykonanych z 2-warstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi. W skład wchodzi barierowa warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej. Waga materiału podstawowego bez wzmocnienia 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; grubość materiału bez wzmocnień około 350 μ m, grubość wzmocnienia 630 μ m (pad + materiał podstawowy). Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O oraz na rozerwanie na sucho obszary niewzmocnione >150 kPa; obszary wzmocnione >300 kPa?
- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na Stolik Mayo wykonanej z włókniny o gramaturze: błona – 57 g/m², błona +włóknina – 93 g/m², błona + wzmocnienie 134 g/m²; grubość filmu około 60 μ m; film + włóknina około 340 μ m. Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho film >80 kPa ; film + włóknina >180 kPa?
- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ściereczek chłonnych o gramaturze 60 g/m² i rozmiarze 33cm x 33cm?

Pozycja 22

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu serwet do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

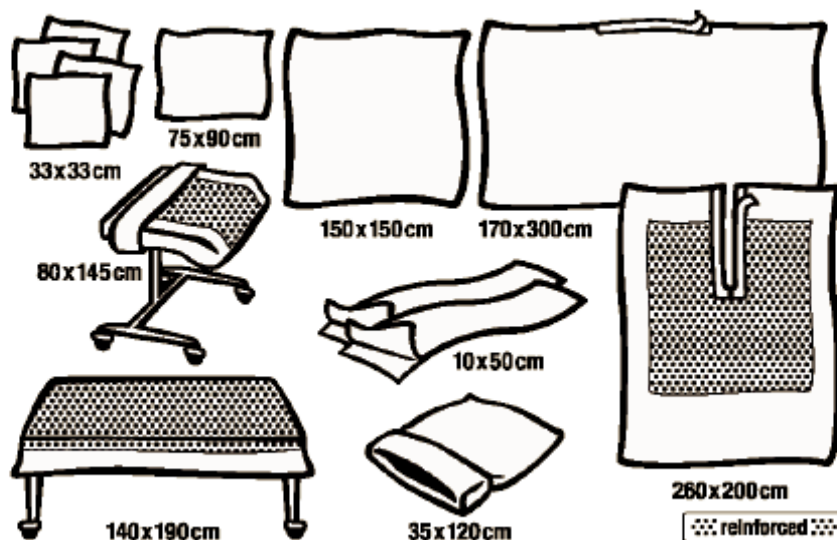

Miejsca wykropkowane:
obszary wzmocnione

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm
- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
- 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:


„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Pozycja 23

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji stawu kolanowego o następującym składzie:

*Miejsca
wykropkowane:
obszary wzmocnione*

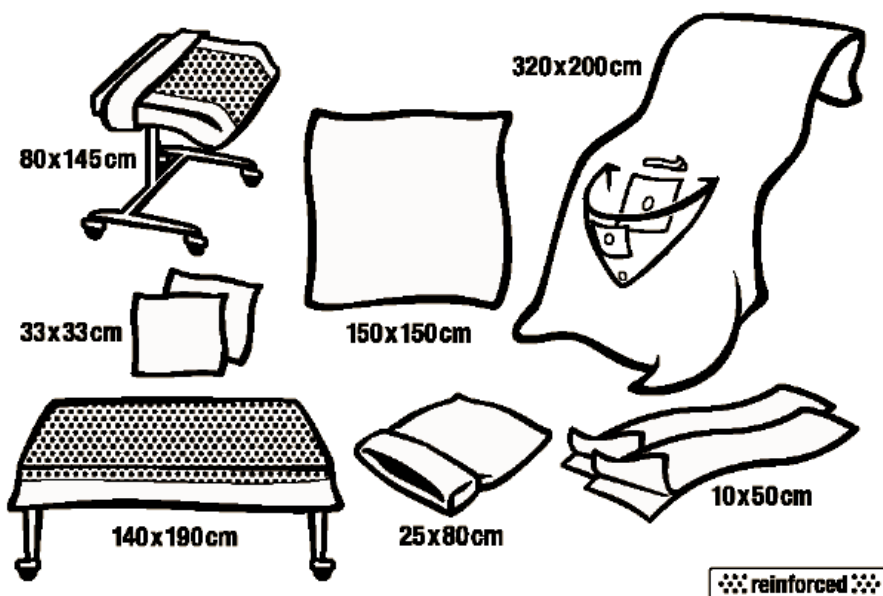

1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm
1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>


Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pozycja 24

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

*Miejsca
wykropkowane:
obszary wzmocnione*

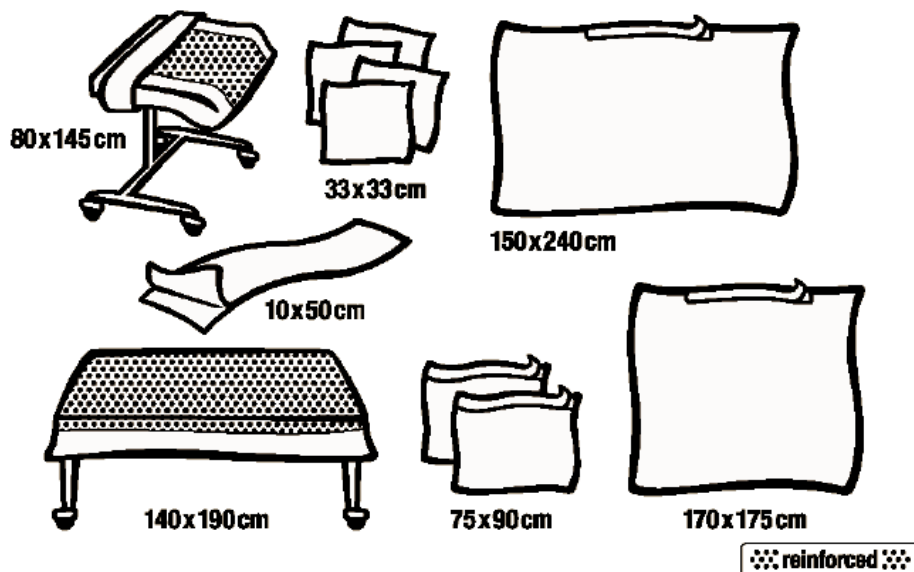

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- Oraz oddzielnie pakowaną dołączoną do zestawu kieszeń samoprzylepną dwukomorową o rozmiarze 43 x 38 cm?

Pakiet nr 1 poz. 22.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- 3 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Pakiet nr 1poz. 23.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana o następującym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy op 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łatą chłonną 50x100 cm i uchwytem na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Pakiet nr 1 poz.24

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

- 1 taśma op. 9x50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łatą chłonną 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łatą chłonną 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Pakiet nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra o składzie:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
 - Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
 - 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
 - Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
 - 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm
 - Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta 170 x 240 cm
 - Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Nogawica 35 x 120 cm
 - Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
 - 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
 - 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm
 - oraz 1 taśmę przylepną o wym. 10 x 50cm pakowaną osobno?
- Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Pakiet nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

- 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
- Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta 3 - warstwowa z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Pakiet nr 1 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm


Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm oraz kieszeń o rozmiarze 30x40cm, 2-częściowa pakowana osobno?

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w razie zaoferowania produktów o parametrach, które zamawiający dopuścił w ww. wyjaśnieniu, należy w Formularzu cenowym złożonej oferty dokonać odpowiednich poprawek.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12a Pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 16.06.2011 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2011 r. o godz. 11:00.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk