



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, 25.10.2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę
staplerów do stosowania w obrębie całego przewodu pokarmowego i wykonania zespolenia
dla SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy RZP-V/1/28/11**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pytanie:

„Czy w przypadku gdy Zamawiający będzie dokonywał zamówień wyrobów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na sztuki, a nie na opakowania, dopuszcza dodanie do oznaczenia kodowego, które będzie zamieszczone na fakturze, symbolu „u” oznaczającego najmniejszą jednostkę towaru (1 sztuke)?”

Odpowiedź: TAK

Zamawiający będzie dokonywał zamówień wyrobów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na sztuki, a nie na opakowania, dopuszcza dodanie do oznaczenia kodowego, które będzie zamieszczone na fakturze, symbolu „u” oznaczającego najmniejszą jednostkę towaru (1 sztuke).

Pytanie dotyczy pozycji 1,2,3:

Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3 dopuści jednorazowe staplery okrężne wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm ,o rozmiarach odpowiednio:25mm i wymiarze okrężnego kalibratora 16,4mm, 29mm o wymiarze okrężnego kalibratora 20,4mm oraz 33mm o wymiarze okrężnego kalibratora 24,4 mm.

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pozycji 1,2,3 dopuszcza jednorazowe staplery okrężne wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm ,o rozmiarach odpowiednio:25mm i wymiarze okrężnego kalibratora 16,4mm, 29mm o wymiarze okrężnego kalibratora 20,4mm oraz 33mm o wymiarze okrężnego kalibratora 24,4 mm.

Pytanie dotyczy pozycji 1:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 punkt 1 dopuści stapler okrężny 25 mm z automatycznym dociskiem tkanki i kowadełkiem które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera o dwóch wysokościach zszywki do wyboru przed zamknięciem 3,5mm po zamknięciu 1,5mm oraz 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm. Średnica noża wynosi min 16.5 mm?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pakiecie 1 punkt 1 dopuszcza stapler okrężny 25 mm z automatycznym dociskiem tkanki i kowadełkiem które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera o dwóch wysokościach zszywki do wyboru przed zamknięciem 3,5mm po zamknięciu 1,5mm oraz 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm. Średnica noża wynosi min 16.5 mm.

Pytanie dotyczy pozycji 1:

Czy Zamawiający jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 26 mm(wymagane 25 mm w SIWZ), średnica noża 17 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Dopuszczenie naszej oferty gwarantuje Zamawiającemu poszerzenie grona oferentów.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”



Odpowiedź: TAK

Zamawiający dopuszcza jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 26 mm, średnica noża 17 mm., ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką .

Pytanie dotyczy pozycji 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 punkt 2 dopuści stapler okrężny 28 mm z automatycznym dociskiem tkanki i kowadełkiem które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera o dwóch wysokościach zszywki do wyboru przed zamknięciem 3,5mm po zamknięciu 1,5mm oraz 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm. Średnica noża wynosi min 19.5 mm?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pakiecie 1 punkt 2 dopuszcza stapler okrężny 28 mm z automatycznym dociskiem tkanki i kowadełkiem które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera o dwóch wysokościach zszywki do wyboru przed zamknięciem 3,5mm po zamknięciu 1,5mm oraz 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm. Średnica noża wynosi min 19.5 mm.

Pytanie dotyczy pozycji 2:

Czy Zamawiający jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 29 mm(wymagane 28 mm w SIWZ), średnica noża 20 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Dopuszczenie naszej oferty gwarantuje Zamawiającemu poszerzenie grona oferentów.

Odpowiedź: TAK

Zamawiający dopuszcza jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 29 mm, średnica noża 20 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Pytanie dotyczy pozycji 3:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 punkt 3 dopuści stapler okrężny 31mm lub 33mm z automatycznym dociskiem tkanki i kowadełkiem które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera o wysokości zszywki 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm. Średnica noża dla średnicy 31 wynosi min 22,5 mm, natomiast dla średnicy 33 wynosi 24,5mm?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pakiecie 1 punkt 3 dopuszcza stapler okrężny 31mm lub 33mm z automatycznym dociskiem tkanki i kowadełkiem które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera o wysokości zszywki 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm, średnica noża dla średnicy 31 wynosi min 22,5 mm, natomiast dla średnicy 33 wynosi 24,5mm.

Pytanie dotyczy pozycji 4:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm .Rozmiar staplera 29mm ?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pozycji 4 dopuszcza jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm .Rozmiar staplera 29mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie dotyczy pozycji 4:

Czy zamawiający w pakiecie 1 punkt 4 dopuści jednorazowe ładunki do prostego staplera okrężnego wielorazowego użytku (użyczanego bezpłatnie) o średnicach 28mm i 31mm lub zgodzi się na wydzielenie tej pozycji z pakietu i stworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pakiecie 1 punkt 4 dopuszcza jednorazowe ładunki do prostego staplera okrężnego wielorazowego użytku (użyczanego bezpłatnie) o średnicach 28mm i 31mm. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie dotyczy pozycji 5:

Czy Zamawiający w pakiecie 1 punkt 5 dopuści stapler liniowy z nożem 60mm (gdzie nóż jest integralną częścią ładunku), który posiada ładunek zamykający na 1,5mm lub na 2,0mm, z systemem zabezpieczającym przez ponownym odpaleniem zużytego ładunku?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający w pakiecie 1 punkt 5 dopuszcza stapler liniowy z nożem 60mm (gdzie nóż jest integralną częścią ładunku), który posiada ładunek zamykający na 1,5mm lub na 2,0mm, z systemem zabezpieczającym przez ponownym odpaleniem zużytego ładunku.

Pytanie dotyczy pozycji 6:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 6 ładunki bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

Odpowiedź: NIE

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 6 ładunków bez zintegrowanego ogranicznika tkanki.

Pytanie dotyczy pozycji 7:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 7 stapler liniowy 60mm z jedną dźwignią dwustopniowego zamykania. Pierwsze ściśnięcie powoduje zamknięcie staplera na tkance, drugie ściśnięcie powoduje odpalenie staplera?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 7 stapler liniowy 60mm z jedną dźwignią dwustopniowego zamykania. Pierwsze ściśnięcie powoduje zamknięcie staplera na tkance, drugie ściśnięcie powoduje odpalenie staplera.

Pytanie dotyczy pozycji 7:

Czy Zamawiający dopuści stapler jednorazowy, z możliwością przeładowywania do 8 razy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Zamawiający dopuszcza stapler jednorazowy, z możliwością przeładowywania do 8 razy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie dotyczy pozycji 8:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 9 stapler liniowy 45mm dedykowany do niskich resekcji pozycjonujący podwójną linię zszywek zamykających na 1,5mm lub 2,0mm lub zgodzi się na wydzielenie tej pozycji z pakietu i stworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 9 stapler liniowy 45mm dedykowany do niskich resekcji pozycjonujący podwójną linię zszywek zamykających na 1,5mm lub 2,0mm. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie dotyczy pozycji 9:

Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy 45 mm(wymagane 40 mm w SIWZ) do niskich resekcji odbytnicy z nożem oraz ramieniem o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm w zależności od zastosowanego ładunku.

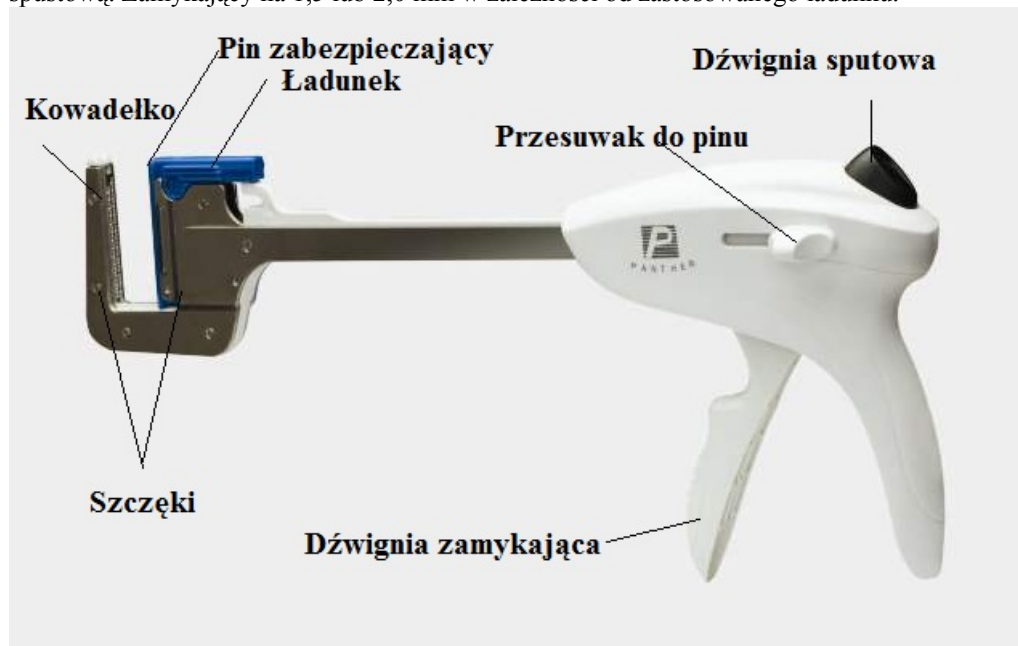

Odpowiedź: TAK

Zamawiający dopuszcza stapler liniowy 45 mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem oraz ramieniem o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm w zależności od zastosowanego ładunku.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Grzegorz Ratajczyk
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk